


|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
|                      | Michèle NOEL (ANSM)<br>Marc CONTI (Créteil) |
| Expédition - Clôture | 30/03/2016 – 25/04/2016                     |

**pH (Unité pH)**

**pH : échantillon 16R**

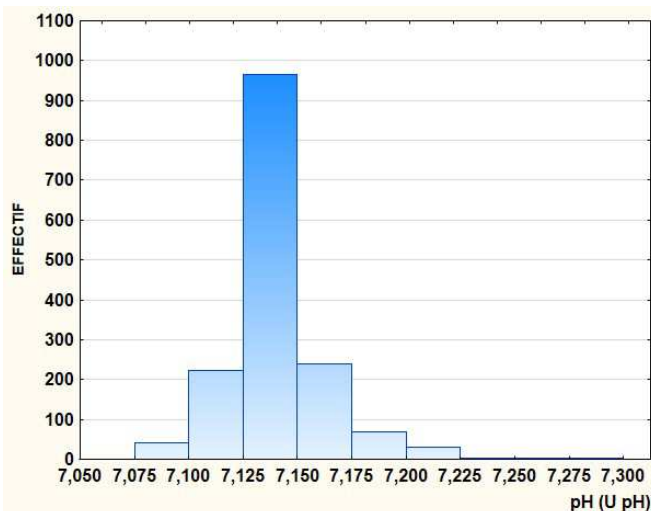


**Effectif**  
1575

**Moyenne générale Tr.**  
7,138

**CV Tr.**  
0,17%

**pH : échantillon 16S**

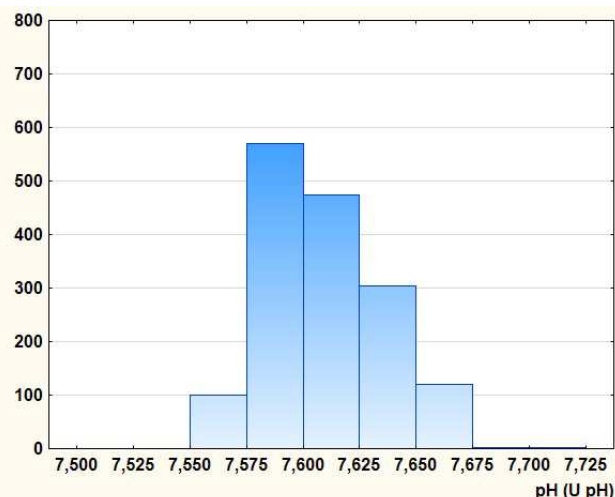


**Effectif**  
1577

**Moyenne générale Tr.**  
7,606

**CV Tr.**  
0,29%

**pO2 (mm Hg)**

**pO2 : échantillon 16R**

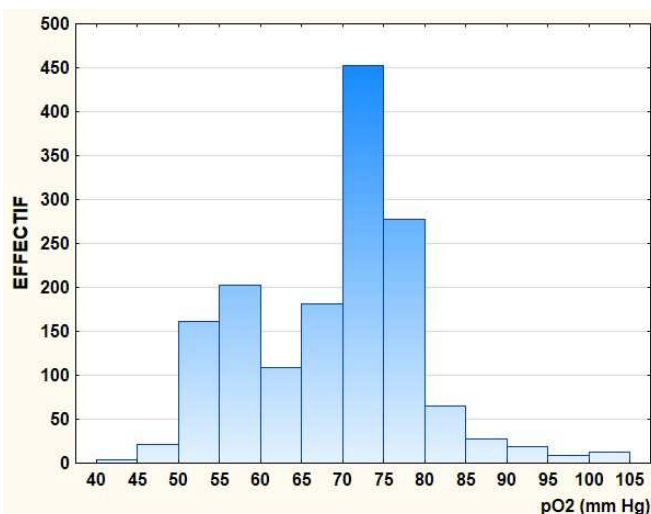


**Effectif**  
1513

**Moyenne générale Tr.**  
68,1

**CV Tr.**  
12,6%

**pO2 : échantillon 16S**

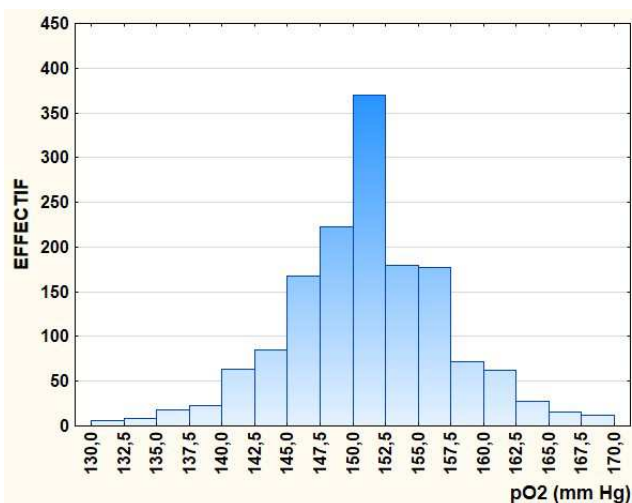


**Effectif**  
1334

**Moyenne générale Tr.**  
144,2

**CV Tr.**  
3,0%

## pCO2 (mm Hg)

pCO2 : échantillon 16R

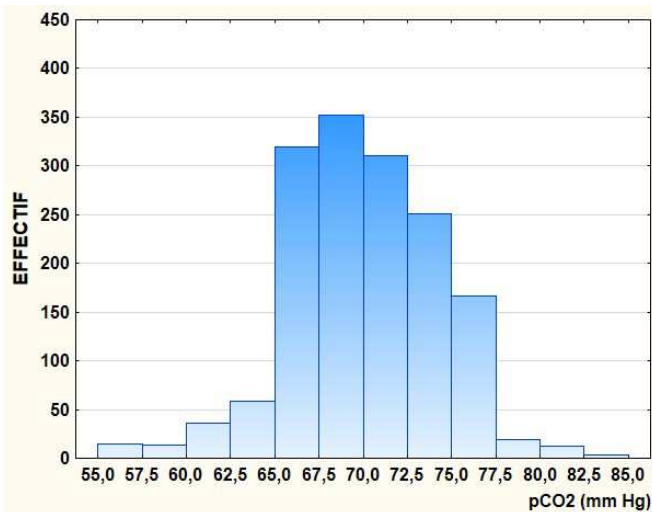


Effectif.  
1557

Moyenne générale Tr.  
70,2

CV Tr.  
4,7%

pCO2 : échantillon 16S

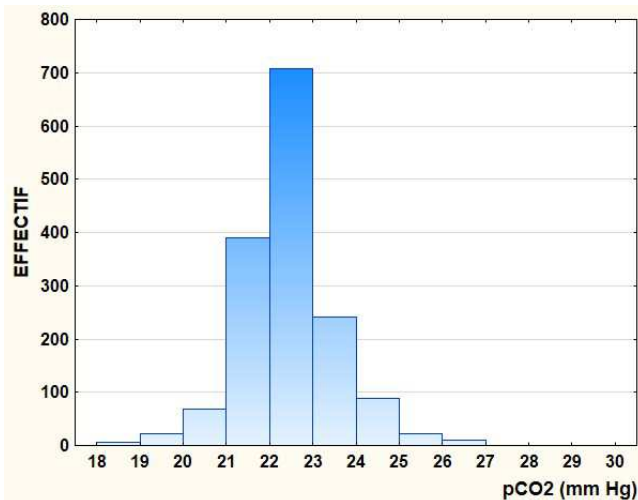


Effectif  
1561

Moyenne générale Tr.  
22,2

CV Tr.  
3,8%

## Glucose (mmol/L)

Glucose : échantillon 16R

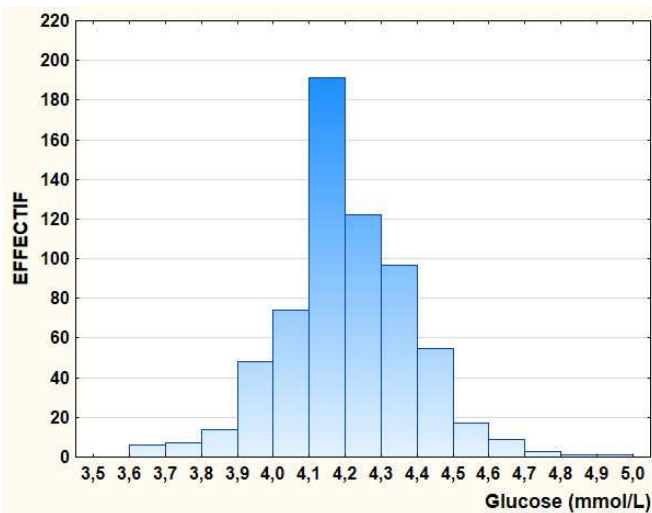


Effectif.  
635

Moyenne générale Tr.  
4,2

CV Tr.  
3,3%

Glucose : échantillon 16S

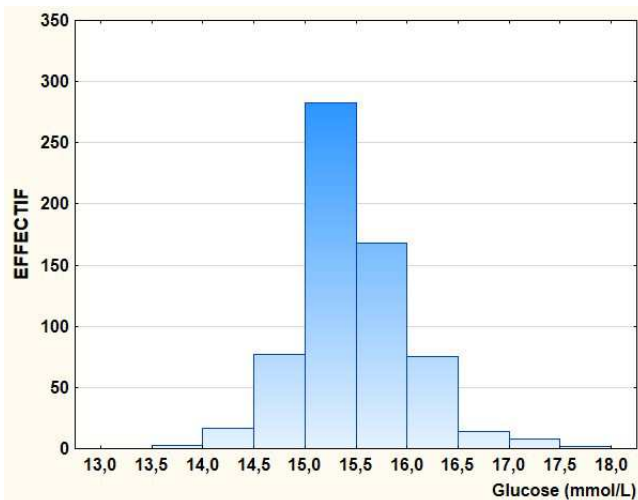


Effectif  
642

Moyenne générale Tr.  
15,4

CV Tr.  
2,4%

## Lactate (mmol/L)

Lactate : échantillon 16R

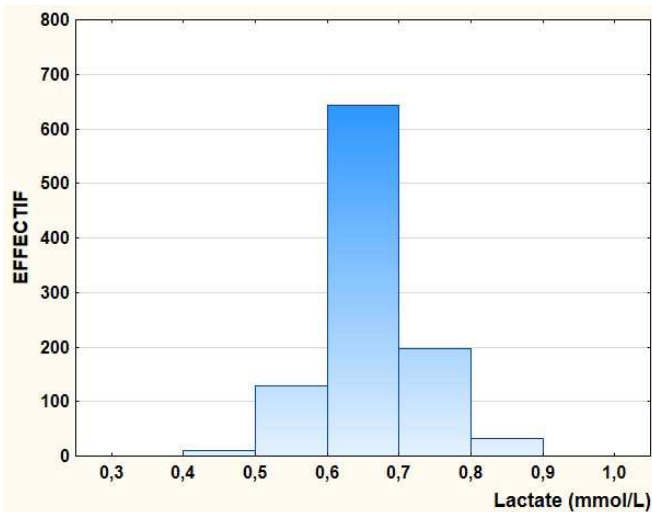


Effectif.  
6831013

Moyenne générale Tr.  
0,61

CV Tr.  
9,3%

Lactate : échantillon 16S

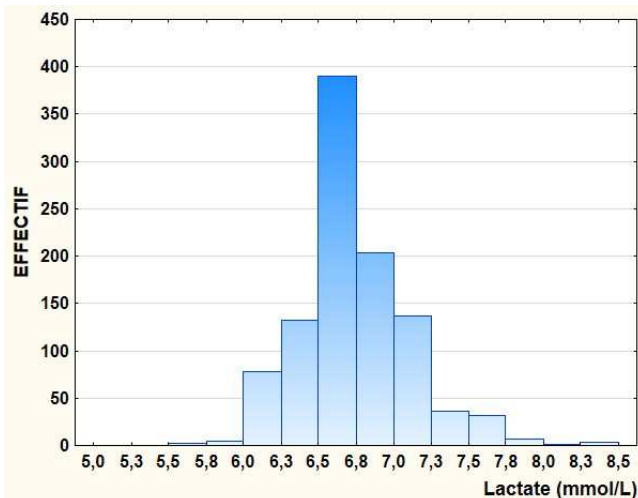


Effectif  
1026

Moyenne générale Tr.  
6,67

CV Tr.  
4,1%

## Calcium ionisé (mmol/L)

Calcium ionisé : échantillon 16R

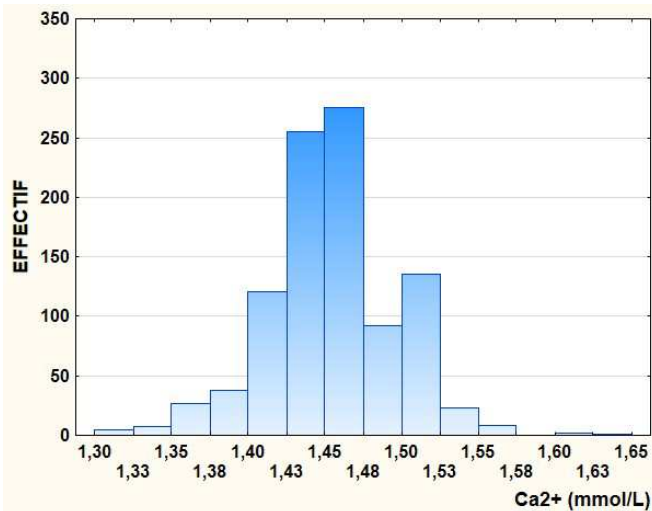


Effectif.  
989

Moyenne générale Tr.  
1,45

CV Tr.  
2,2%

Calcium ionisé : échantillon 16S

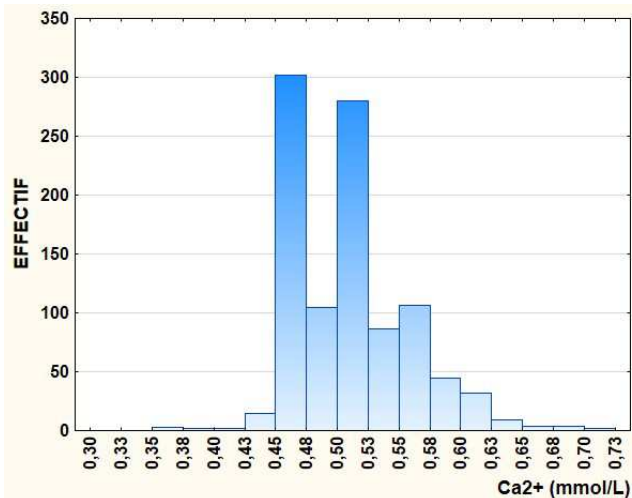

Effectif  
997

Moyenne générale Tr.  
0,50

CV Tr.  
7,5%