


Michèle NOEL (ANSM)
Marc CONTI (Créteil)

Expédition - Clôture

25/03/2015 – 20/04/2015

pH (Unité pH)

pH : échantillon 15R

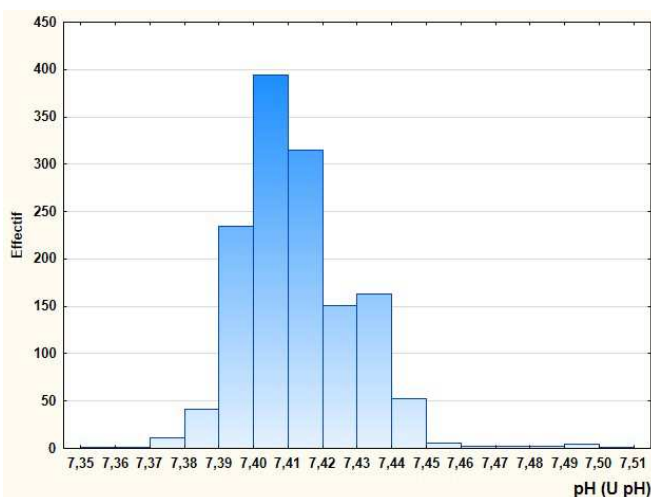


Effectif
1380

Moyenne générale Tr.
7,409

CV Tr.
0,16%

pH : échantillon 15S

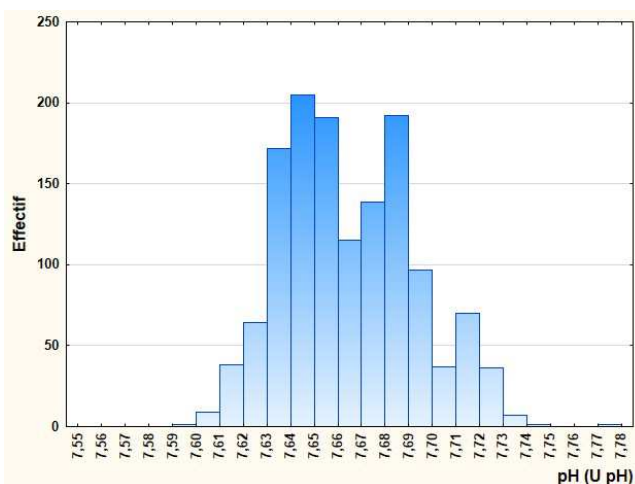


Effectif
1375

Moyenne générale Tr.
7,658

CV Tr.
0,28%

pO2 (mm Hg)

pO2 : échantillon 15R

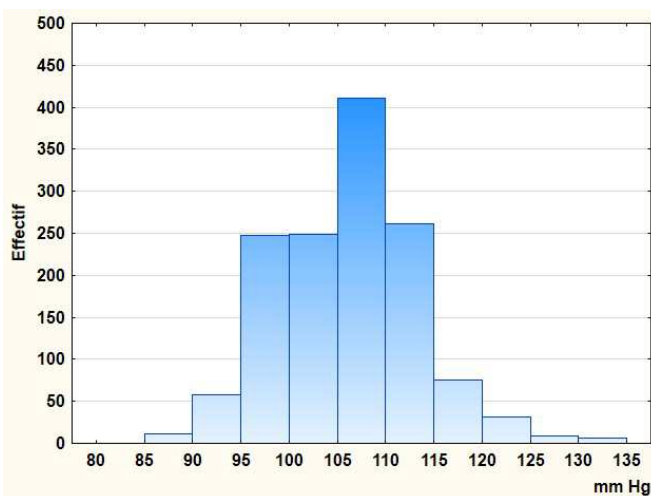


Effectif
1359

Moyenne générale Tr.
105,3

CV Tr.
5,4%

pO2 : échantillon 15S

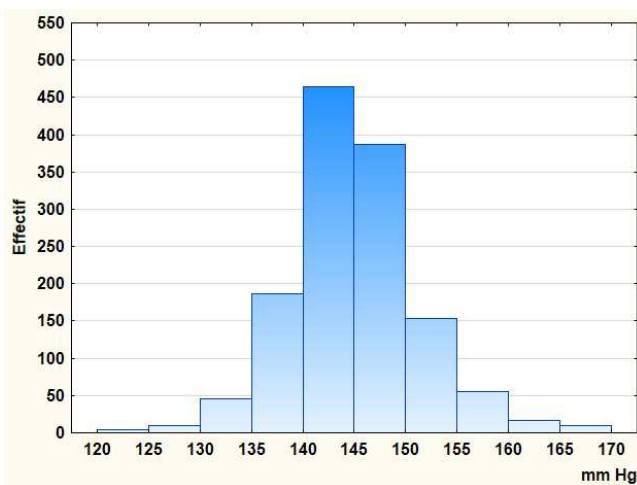


Effectif
1334

Moyenne générale Tr.
144,2

CV Tr.
3,0%

pCO2 (mm Hg)

pCO2 : échantillon 15R

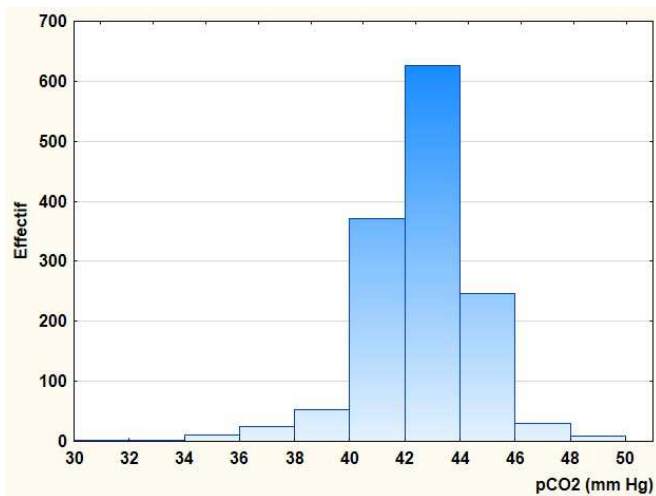


Effectif.
1373

Moyenne générale Tr.
42,6

CV Tr.
3,0%

pCO2 : échantillon 15S

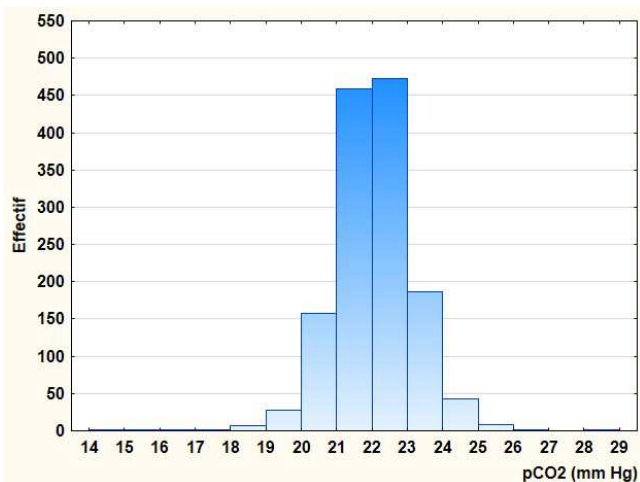


Effectif
1369

Moyenne générale Tr.
21,8

CV Tr.
4,4%

Sodium (mmol/L)

Sodium : échantillon 15R

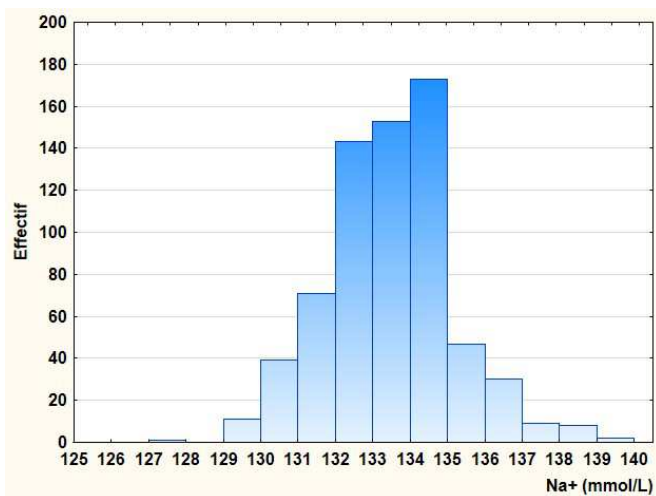


Effectif.
687

Moyenne générale Tr.
133,0

CV Tr.
0,9%

Sodium : échantillon 15S

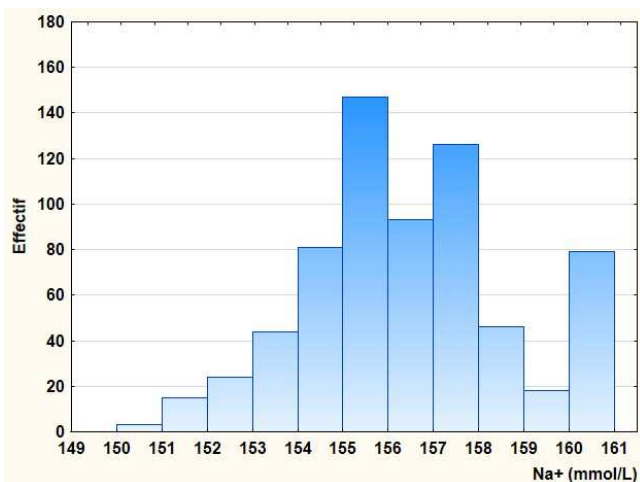


Effectif
676

Moyenne générale Tr.
156,1

CV Tr.
1,4%

potassium (mmol/L)

potassium : échantillon 15R

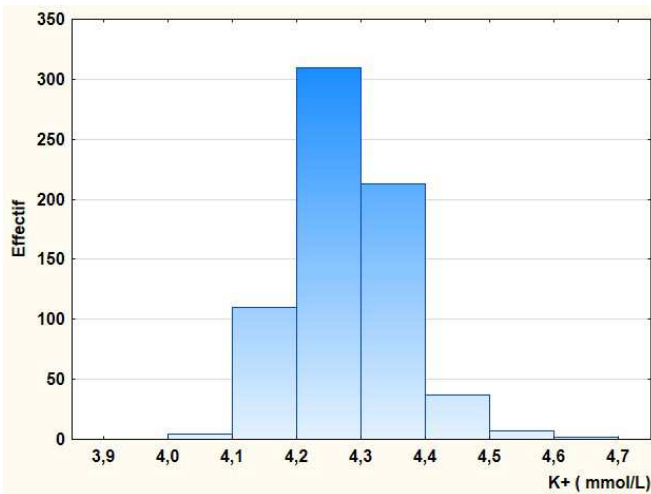


Effectif.
683

Moyenne générale Tr.
4,22

CV Tr.
1,6%

potassium : échantillon 15S

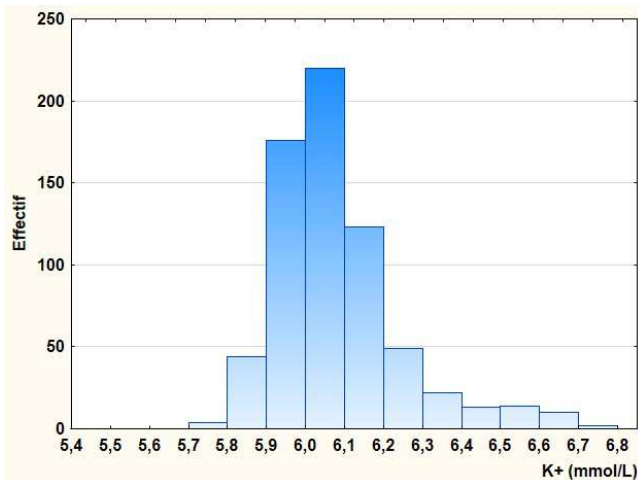


Effectif
677

Moyenne générale Tr.
6,0

CV Tr.
1,7%

Calcium ionisé (mmol/L)

Calcium ionisé : échantillon 15R

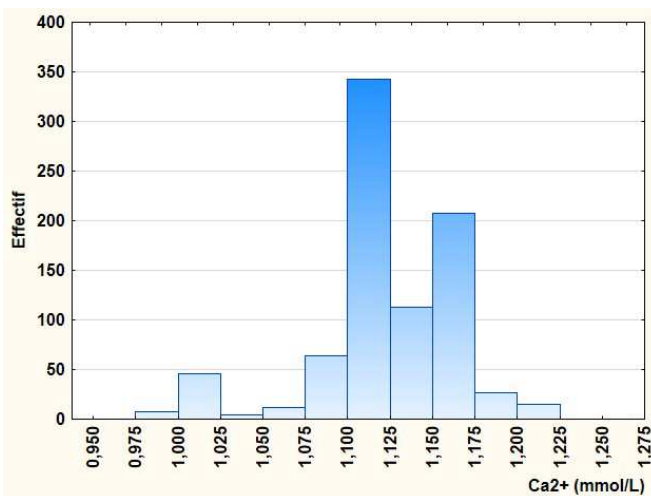


Effectif.
840

Moyenne générale Tr.
1,13

CV Tr.
2,2%

Calcium ionisé : échantillon 15S

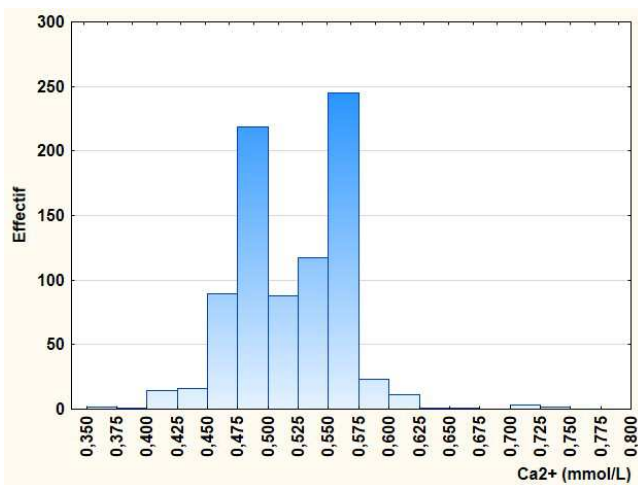

Effectif
833

Moyenne générale Tr.
0,52

CV Tr.
7,0%